Guide de bonnes pratiques d'hygiène

HEKA

Conçu pour l'hygiène

Heka S+ est conçu pour garantir une hygiène et une propreté optimales. Cela est reflété dans les détails bien réfléchis tels que l'utilisation d'une surface en verre trempé qui grâce à sa surface lisse et dure est particulièrement facile à nettoyer et à désinfecter.
L'écran tactile intégré au lieu de boutons et d'interrupteurs garantit l'absence de l'accumulation de poussières ou de saletés dans ces derniers.

Nettoyage général des surfaces

Toutes les surfaces de l'unit sont soit en fonte d'aluminium, soit en verre trempé. L'écran tactile peut être verrouillé lors du nettoyage et se déverrouille automatiquement après deux minutes de sorte que l'unit est de nouveau prêt pour le patient suivant.

Tous les points de contact naturels, tels que les poignées et les supports des instruments, peuvent facilement être retirés afin d'être nettoyés et stérilisés par autoclavage. C'est également le cas pour les poignées du scialytique.

Rinçage automatique des instruments

Un rinçage efficace du système de l'eau de l'unit et des cordons des instruments est primordial pour éviter la formation de biofilms. Le rinçage automatique des instruments permet de rincer facilement les cordons des instruments entre un patient et un autre - rapidement et efficacement.
Il est facile d'activer le rinçage du crachoir après le rinçage des instruments pour rincer également cette partie du système d'eau.

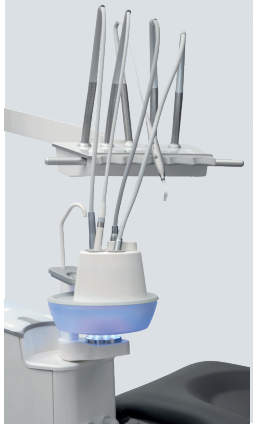

Système de rinçage des tuyaux d'aspiration

Avec le rinçage automatique des tuyaux d'aspiration, une buse activée à l'extrémité des tuyaux d'aspiration nettoie régulièrement le système d'aspiration avec des produits chimiques ou simplement de l'eau propre ; ce qui contribue à maintenir l'ensemble du système d'aspiration propre et efficace.
Il est possible d'activer le rinçage avec des produits chimiques ou seulement de l'eau tout en travaillant avec un patient.

Une élimination efficace de toutes les impuretés est ainsi garantie sans que le tuyau se dessèche et que les impuretés se solidifient à l'intérieur du tuyau.
Un rinçage régulier avec des produits chimiques actifs entre un patient et un autre ou le soir peut assurer une réduction de la formation de germes et de bactéries dans le système d'aspiration.

Crachoir / Vanne de crachoir / éventuellement séparateur d'amalgame

Assure une évacuation efficace de l'eau du système de crachoir. Un séparateur d'amalgame triera également l'amalgame de l'eau du crachoir.

Le bol du crachoir peut facilement être retiré pour le nettoyer.

Purification active de l'eau

Si l'option de la purification active de l'eau est choisie, le liquide nettoyant actif sera dosé en continu dans le système d'eau de l'unit afin de réduire la création des bactéries et d'éviter la formation de biofilm.
Le système de purification de l'eau est disponible en deux versions, avec ou sans coupure de la ligne d'eau selon les directives en vigueur.

Routines de nettoyage de l’unit

Le matin

- Rincer les instruments avec le système de rinçage automatique des instruments - programme long
- Rincer le système d’aspiration en utilisant le nettoyage automatique des tuyaux d’aspiration (ou en aspirant le liquide nettoyant).

Avant chaque patient

- Nettoyage et désinfection des surfaces et des cordons des instruments, y compris les poignées et la garniture du fauteuil
- Programme court de rin-çage des instruments avec le système de rinçage automatique.
- Rinçage du système d’aspiration à l’aide des produits chimiques actifs pour le dés- infecter de l’intérieur - les pièces à main des tuyaux d’aspiration doivent être nettoyées et essuyées avec un désinfectant approuvé.

Le soir

- Rincer le système d’aspiration avec des produits chimiques actifs. Les pièces à main des tuyaux d’aspiration doivent être enlevées et nettoyées conformément aux prescriptions réglementaires du cabinet.
- Vérifier et nettoyer les filtres dans les tuyaux d’aspiration
- Retirer les poignées et le support des instruments - les nettoyer et les passer à l’autoclave conformément aux prescriptions du cabinet.

Autres

(en cas de besoin)

- Vérifier et recharger, si nécessaire, les produits chimiques utilisés dans les systèmes de nettoyage de l’aspiration et/ou du purificateur d’eau actif
- Vérifier le filtre de la vanne de crachoir/faire le vidange et nettoyer si nécessaire
- Éventuellement remplacer la cassette d’amalgame si elle est pleine.

Ces instructions sont d’ordre général. L’unit doit naturellement toujours être nettoyé selon les directives en vigueur.

Veuillez consulter également le manuel d’utilisation : KA-0111 pour des instructions détaillées sur le nettoyage nécessaire de Heka S^{+}.

HEKA

Document Heka Dental : KA-0260